I.V.ポール（車椅子用）
取扱説明書

1. 安全上の注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 耐荷重は5kgです。車椅子が転倒するおそれがありますので、本品にそれ以上の無理な力がかからないようにしてください。
3) 各固定ノブがしっかり締まっているか、定期的に（週に一回以上）点検してください。
ノブがゆるんだ状態で使用されますと、転倒や破損の原因となります。必ず定期的に点検を行い、ゆるみがある場合は増し締めをしてください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称

部品名	数量
①上パイプ（φ16㎜×900㎜）	1
②下パイプ（φ19㎜×940㎜）	1
③フック	1
④マジックカフ	1
⑤上パイプ固定ノブ	1
⑥車椅子取付用ノブ	1
⑦下パイプ固定ノブ	1
⑧固定ホルダーⒶ	1
⑨固定ホルダーⒷ	1
⑩プッシュボタン	1
⑪ストッパー	1
⑫割りピン(7/8 ｲﾝﾁ(22㎜)パイプ用) (3/4 ｲﾝﾁ(19㎜)パイプ用)	各1組

耐荷重　：5kg
全長　　：1390～1820㎜
重量　　：約1.1kg

3. 使用方法とその注意事項

注意

① 車椅子への取り付けは、平坦な場所で行ってください。
② 必ず車椅子のブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で取り付けてください。
③ 固定ホルダーⒶは1インチ(25㎜)パイプ用です。車椅子のパイプがそれより細い場合、固定ホルダーⒶに付属の割りピンを取り付けてください。
(次頁の【割りピンの取付方法(車椅子のパイプが細い場合)】参照。)

1) 車椅子取付用ノブをゆるめて固定ホルダーⒶから取り外します。
2) 固定ホルダーⒶ、Ⓑを車椅子のパイプにしっかりとはめこみます。（右図参照）。

3) 取り外した車椅子取付用ノブを固定ホルダーⒶに取り付け、しっかりと締めます。
下パイプ固定ノブをしっかりと締めます。

 注意

各固定ノブ・取付用ノブは、車椅子の車輪に触れないよう車椅子の内側に取り付けてください。

4) マジックカフを車椅子のパイプに巻きつけます。
5) 上パイプを下パイプに差し込み、上パイプ固定ノブを締めて固定します。
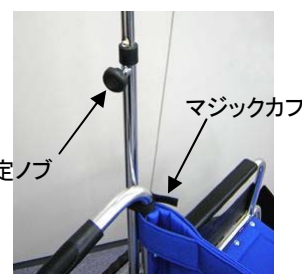
マジックカフ

6) プッシュボタンを押しながら、フックを上パイプに差し込みます。

【割りピンの取付方法（車椅子のパイプが細い場合）】

1) 固定ホルダーⒶから車椅子取付用ノブを取り外します。
2) 割りピンを右図のように固定ホルダーⒶに挿入し、車椅子のパイプに取り付けます。（割りピンにより19mm、22mmのパイプに取り付けが可能となります。）
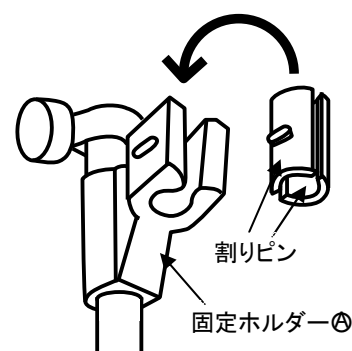
4. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

注文コード	品番	商品名
502-022-32	HP2011	I.V.ポール（車椅子用）